Reutter
Desde 1915

TUBO DE EXTRACCIÓN VENOSA AL VACÍO CON TAPA LILA

Equipos de infusión y jeringas

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Tubo de extracción venosa al vacío con tapa lila.
Marca:	Cranberry.
Material:	Plástico de politereftalato de etileno (PET) y paredes internas de silicona
Color:	Tubo transparente, con tapa lila.
Tallas:	Las medidas del tubo son estándares y compatibles con todos los equipos automatizados.
Presentación:	Bandeja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Los tubos de extracción venosa con anticoagulante EDTA.K2 se utilizan para la examinación total de la sangre en hematología. El EDTA.K2 se une a los iones de calcio y de esta manera bloquea la cascada de coagulación. Los eritrocitos (glóbulos rojos), los leucocitos (glóbulos blancos) y trombocitos(plaquetas) en una muestra anticoagulada con EDTA.K2 son estables hasta por 24 horas.		
Látex:	No.	**Estéril:**	Si, en rayos gamma.
Vigencia:	2 años a partir de la fecha de fabricación.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 4° y 25° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. Importante no usar si el tubo está abierto o dañado.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- En las pruebas realizadas en laboratorios clínicos o tomas de muestras a partir de sangre venosa, la elección del tubo dependerá de lo que se desee analizar en la muestra de sangre.
- Si desea recolectar sangre total, debe usar tubo de extracción venosa al vacío EDTA.K2 con tapa lila, es usado para hematología clínica, pruebas cruzadas, grupos sanguíneos y diversos análisis de células sanguíneas.
- El tubo con tapa lila puede soportar una presión de 50Kpa durante 15 segundos sin agrietarse.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho del tubo	Largo del tubo	Volumen de vacío	Aditivo anticoagulante
AATUBOM1	1,3 cm	10 cm	6 mL	EDTA.K2

Cranberry®

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

contacto@reutter.cl
+56 2 2489 7000
Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

Reutter
Desde 1915

TUBO DE EXTRACCIÓN VENOSA AL VACIÓ CON TAPA LILA

Equipos de infusión y jeringas

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- EC certificate.
- ISO 13485 : 2016.
- FDA registration.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

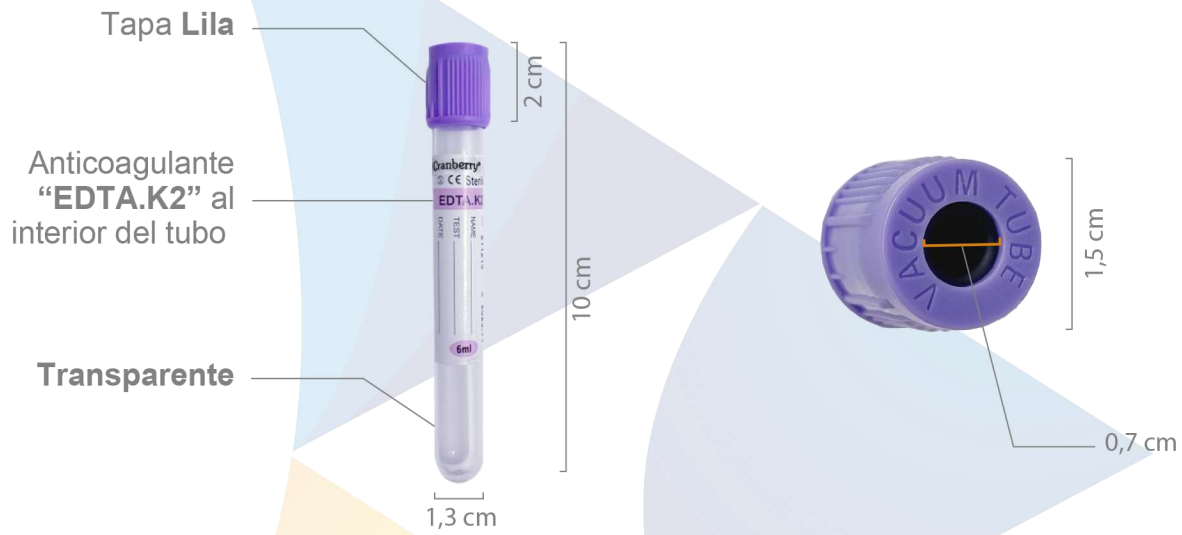

Cranberry®

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

contacto@reutter.cl
+56 2 2489 7000
Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl